

POLICLÍNICA ESTADUAL

Da Região Oeste - São Luís de Montes Belos

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS

São Luís de M. Belos

05/04/22

SETOR SOLICITANTE	RESPONSÁVEL
MULTIPROFISSIONAL	MATEUS CLEMENTE CARLOS DOS SANTOS
DIRETORIA IMEDIATA	RESPONSÁVEL
Diretoria Geral	MARTA SELMA DA SILVA DA SILVEIRA

DESCRIÇÃO DETALHADA (BEM, OBRA, SERVIÇOS)

Compras de materiais em caráter regular para a implantação da Unidade Policlínica Estadual da Região Oeste de São Luís de Montes Belos visando aprimoração do serviço multiprofissional.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DO FLUXO DE TOSSE
SHAKER CLASSIC
FLUXOMETRO 0-15 FEMEA P/ OXIGÊNIO (VERDE) PROTEC
FLUXOMETRO 0-15 FEMEA P/ AR COMPRIMIDO (AMARELO) PROTEC
ASPIRADOR DE REDE STANDARD VAC COM FRASCO 500ML PROTEC
FITA DE KINESIO BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA 5MX5CM
BOLA DE DENTE DE LEITE 300g

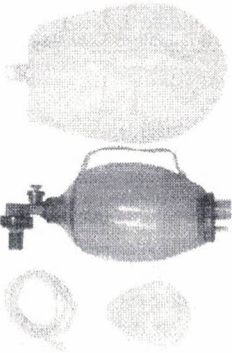
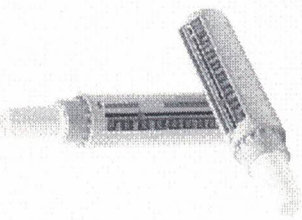
*** ANEXAR DOCUMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, SE NECESSÁRIO****JUSTIFICATIVA**


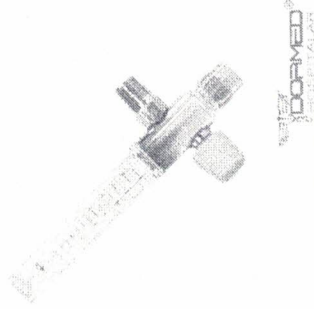
A contratação se faz necessária para atender aos serviços dos contratos de gestão junto a SES-GO referente a Prestação de Serviços às unidades Hospitalares e Policlínicas Estaduais. São eles os seguintes contratos: Edital de Chamamento Público Nº 06/2021-SES/GO referente a Policlínica Regional-Unidade São Luís de Montes Belos, Edital de Chamamento Público Nº 07/2021-SES/GO referente a Policlínica Regional-Unidade Goiás, que autoriza o IBGC a realizar as contratações e demais procedimentos indispensáveis e necessários para o pleno funcionamento das unidades e a atender a RDC Nº 36, DE 25 DE JULHO DE 2013 do Ministério da Saúde - Anvisa, que institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências. Entretanto se faz necessário aquisição dos itens supracitados em virtude que a unidade não possui dispositivos mencionados, o qual se torna necessário a compra destes.

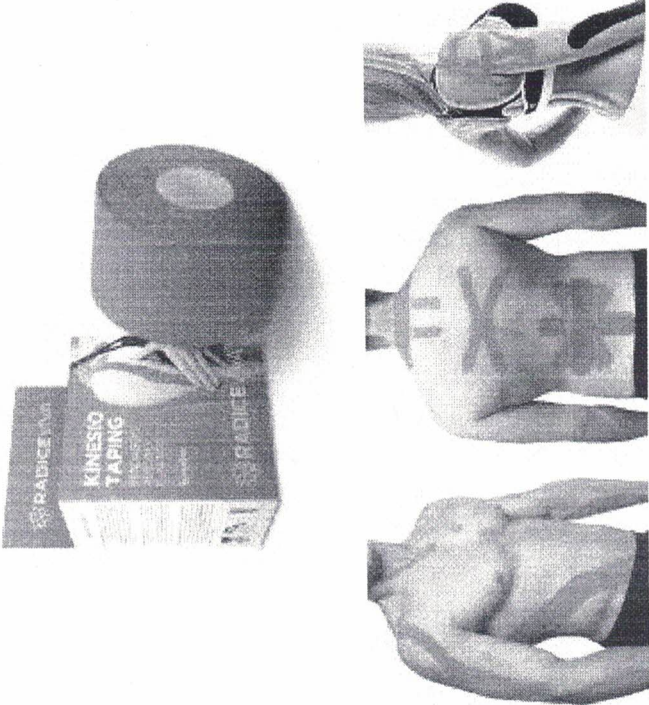
OBSERVAÇÕES:

NECESSIDADE	(X) REGULAR () EMERGENCIAL	DATA: 05/04/2022				
ENDEREÇO DE ENTREGA:						
Mateus Clemente C. dos Santos Supervisor Multiprofissional CREMOP/GO/302135-F UPL/IBGC ASSINATURA / CARIMBO DO SOLICITANTE	De acordo: MARTA SELMA DA SILVEIRA DIRETORIA GERAL ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Ao Setor de Compras/Processo Seletivo para providências	PROCESSO DE COMPRAS / PROCESSO SELETIVO DE FORNECEDOR	<table><tr><th>NÚMERO</th><th>ANO</th></tr><tr><td>8</td><td>2022</td></tr></table>	NÚMERO	ANO	8	2022
NÚMERO	ANO					
8	2022					
ASSINATURA / CARIMBO DIRETORIA GERAL	Marcia Sousa Gerente de Compras IBGC / MATRIZ ASSINATURA / CARIMBO SETOR DE COMPRAS/PROCESSO SELETIVO 05/04/22					

ANEXO I - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS - MULTIPROFISSIONAL

MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	IMAGEM ILUSTRATIVA
RESSUSCITADOR LUMIAR COM ALÇA ADULTO - LUMIAR HAELTHCARE	Resuscitador - Reanimador de Borracha Adulto - NÃO CLAVÁVEL, O Reanimador é utilizado para o atendimento nos primeiros socorros em pacientes que necessitem de ventilação pulmonar, seja por doença ou acidentes, caso não haja o uso do mesmo o paciente pode vir a ter o comprometimento de sua vida. A ventilação artificial geralmente é utilizada com bastante frequência em salas de emergência, unidades de terapia intensiva, anestésias, recuperação pós anestésica, centros esportivos, ambulâncias de resgate e outras aplicações médicas	10	
ACAPELLA - TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA PARA MOBILIZAÇÃO DE SECREÇÕES - POLITEC	Acapella - Terapia Vibratória Expiratória para Mobilização de Secreção - Politec	3	
DISPOSITIVO PARA AVALIAÇÃO DO FLUXO DE TOSSE	O Medidor de fluxo expiratório; uso Adulto e Infantil; Com válvula unidirecional em silicone; Calibrado individualmente e manualmente; Corpo: Plástico; Bocal: Plástico (autoclavável até 134°C); Barra Interna: Aço Inoxidável; Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças;	2	

	Calibração: Manual; Válvula unidirecional: silicone; Dimensões: 19,5x4, 4cm (comprimento x diâmetro);		
SHAKER CLASSIC	Exercitador respiratório e incentivador da higiene brônquica de oscilação oral de alta frequência. Componentes: Corpo, tampa, cone, esfera e boca em polipropileno. Materiais: - Corpo: polipropileno; - Tampa: polipropileno; - Cone: polipropileno; - Bocal: PVC; - Esfera: Aço carbono com revestimento superficial.	2	
FLUXOMETRO 0-15 FEMEA P/ OXIGÊNIO (VERDE) PROTEC	Com a finalidade de ajustar e indicar o fluxo de gás em l/pm (litros por minuto) a ser administrado ao paciente.	7	
FLUXOMETRO 0-15 FEMEA P/ AR COMPRIMIDO (AMARELO) PROTEC	Foram desenvolvidos para controlar e medir o fluxo de Ar comprimido medicinal, Oxigênio, Óxido nítrico, Gás carbônico, Nitrogênio ou Argônio.	2	

ASPIRADOR DE REDE STANDARD VAC COM FRASCO 500ML PROTEC	Frasco em vidro de 500ml; Possui vacuômetro; Possui boia para evitar transbordamento.	2	
FITA DE KINESIO BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA 5MX5CM	A kinesio tape é uma técnica que consiste em "tapes" adesivos que são peculiares por não limitar os movimentos. A kinesiology tape é aliada aos tratamentos tradicionais e seu uso pode reduzir o tempo de cura. Este método possui ação neuromuscular e têm como principais funções dar suporte muscular, ajudar na drenagem vascular e linfática, ativar o sistema analgésico endógeno, auxiliar na circulação do sangue por todo o corpo e promover a regeneração tecidual. A aplicação de kinesio reduz edemas e a dor de lesões musculares. Isso ocorre porque a dor causada pela pressão exercida nos receptores sensoriais e neurológicos, é aliviada por meio das ondulações que a bandagem promove, elevando a pele. Melhorando desta forma a circulação sanguínea e permitindo que o sistema linfático flua mais livremente. A bandagem elástica pode ser usada em pacientes de todas as idades, inclusive em bebês para amenizar os efeitos das cólicas. É também recomendada no tratamento de pessoas que sofreram derrame e tiveram algum tipo de paralisia muscular.		

BOLA DE DENTE DE LEITE 300g	Bola dente de leite, para realizar fortalecimento muscular e terapias lúdicas.	5		



Documento assinado eletronicamente por MARCIA APARECIDA DE SOUSA, 370.319.021-34, COMPRADOR, em 06/04/2022 às 08:47, conforme horário oficial de Brasília/DF, com fundamentos na portaria nº 117/2020



Este documento foi assinado digitalmente. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: <https://ibgc.vozdigital.com.br/virtualdoc/public/validar-assinatura-anexo> informando o código 791 e o código verificador 275.